

Nitrogen Oxides Analyzer

窒素酸化物自動計測器

光化学スモッグや酸性雨などの大気汚染の原因物質である環境大気中の窒素酸化物濃度を化学発光方式で正確に連続測定する自動計測器です。

KIMOTO



NA-721

交流法の採用でゼロドリフトの小さい高精度測定を実現

同時校正機能を標準装備しスバンドリフトの小さい高精度測定を実現

大型カラーLCDタッチパネルを採用し豊富な情報表示と快適な操作性を実現

大容量のデータメモリを内蔵し測定データ、動作情報を1年分保存可能

汎用USBメモリで測定データの取出しが可能

環境省テレメータ取り合い共通仕様に適合したデジタルテレメータ入出力機能を標準装備

仕様


| | | | |
|-------------------|--|----------------|---|
| 測定対象 | 環境大気中の窒素酸化物 (NO ₂ , NO, NO _x) | 暖機時間 | 3時間以下 |
| 測定原理 | 化学発光方式 (JIS B 7953) | 許容周囲温度 | 0~40℃ |
| 測定範囲* | 0~1ppm (標準), 0~2ppm (オプション) | 試料吸引流量 | 約1ℓ / 分 |
| アナログ出力レンジ* | 0~0.1/ 0.2/ 0.5/ 1ppm 4レンジ自動切換 (標準), 0~0.2/ 0.5/ 1/ 2ppm 4レンジ自動切換 (オプション) ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能 | ダストフィルタ* | φ47mmふっ素樹脂フィルタ |
| 繰返し性(再現性) | スパンガス濃度の±1% | LCD表示 | 測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム |
| ゼロドリフト | ±1ppb/週 | 内部メモリー保存 | 測定値(1分値, 1時間値), 動作制御情報, メッセージ, アラーム |
| スバンドリフト | スパンガス濃度の±2%/日, ±4%/週 | デジタル入出力 | Ethernet, USB1.1, RS232C |
| 直線性(指示誤差) | 中間点スパンガス濃度の±4% | 打点式記録計出力* | 連続値, 1時間積算平均値, 日報, 動作情報 |
| 電源電圧変動に対する指示値の安定性 | スパンガス濃度の±1%/100±10V | デジタルテレメータ用入出力 | 環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様に適合した入出力 |
| 周囲温度変化に対する指示値の安定性 | ゼロ: ±1ppb以内/5℃変化 スパン: スパンガス濃度の±2%以内/5℃変化 | アナログテレメータ用入出力* | DC0~1V: 連続値, 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等 |
| コンバータ効率 | 96%以上 | 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 約300VA |
| 応答時間 | 3分以下(最終指示値の90%までの時間) | 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし |
| 検出限界 | 1ppb以下 | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 干渉影響 | 4ppb以下 (NH ₃ 1ppm), 4%以下 (水分 25℃ 80%RH) | | |

(*) 標準外仕様についてはご相談ください。



周辺装置

| | | | |
|--------|---|------------------|--|
| 床立型ラック | A0865: 高さ865mm キャスタ付フレームラック A1120: 高さ1120mm キャスタ付フレームラック | アナログテレメータ入出力ユニット | TU07: ネジ締め端子台 (床立型ラック背面取付) |
| レコーダ | 打点式記録計 記録紙有効幅180mm | 標準ガス調製装置 | DS-071N: 流量比混合1点希釈装置 NA-721からの自動制御運転 コンバータ効率試験ガス発生機能内蔵 高純度ゼロガス発生器内蔵 |

■ 流路図

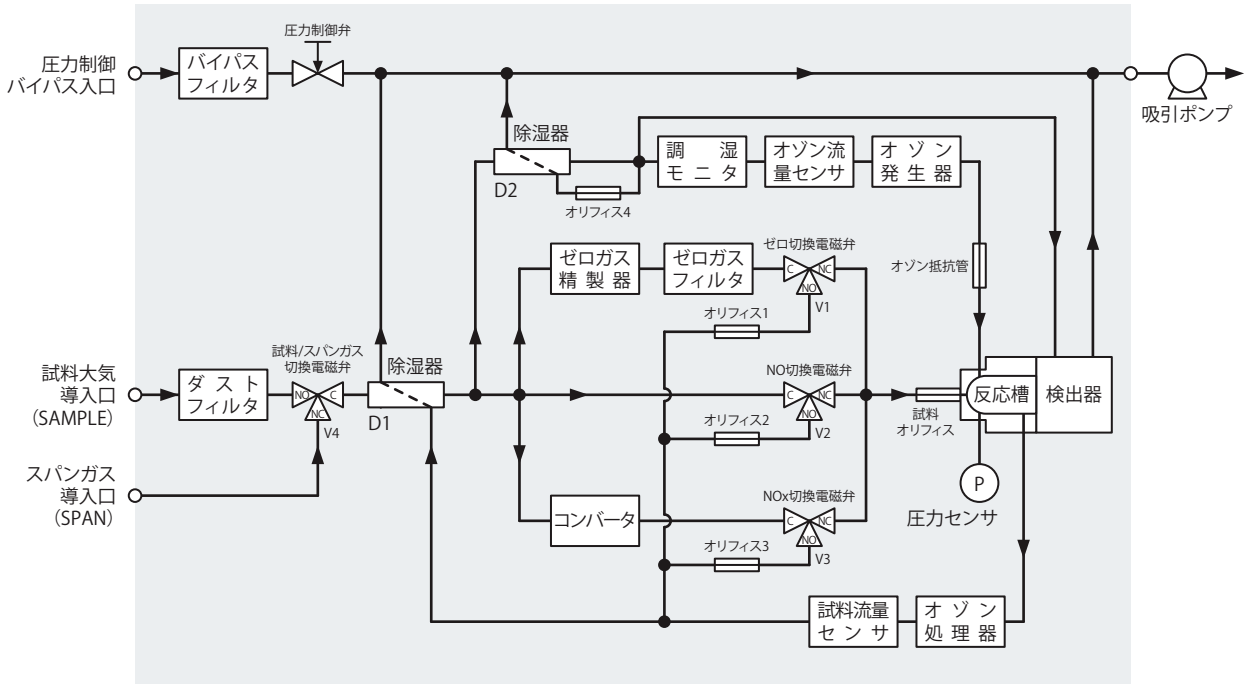

■ 分析部本体およびラックケース寸法 (mm)



■ 製品コード

NA-721-□□□□□

| | |
|----|-----------------------|
| T1 | 卓上型 |
| A3 | 床立型ラック A0865 |
| A4 | 床立型ラック A1120 |
| R | 打点式記録計 |
| 0 | 適用なし |
| T | アナログテレメータ入出力ユニット TU07 |
| 0 | 適用なし |
| D | 標準ガス調製装置 DS-071N |
| 0 | 適用なし |
| 1 | 測定範囲 0~1ppm |
| 2 | 測定範囲 0~2ppm |

⚠ 安全に関するご注意

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。

人・社会・自然の関わりをはかる **KIMOTO**
紀本電子工業株式会社
<http://www.kimoto-electric.co.jp/>

■ 本社・工場 〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町3-1
 TEL 06-6768-3401 FAX 06-6764-7040
 ■ 東京営業所 〒140-0013 東京都品川区南大井3-24-13
 TEL 03-3761-8191 FAX 03-3761-8194
 ☑ E-Mail sales@kimoto-electric.co.jp