

窒素酸化物・浮遊粒子状物質 自動計測器

本装置は化学発光方式による窒素酸化物自動計測器 (NA-721) とβ線吸収方式による浮遊粒子状物質自動計測器 (PM-711) をラックに統合した複合計測器です。

交流法の採用でゼロドリフトの小さい
高精度測定を実現


ふっ素樹脂テープろ紙を標準採用し湿度や
ガス成分の影響の少ない高精度測定を実現

大型カラーLCDタッチパネルを採用し
豊富な情報表示と快適な操作性を実現

汎用USBメモリで
測定データの取出しが可能


大容量のデータメモリを内蔵し
測定データ、動作情報を1年分保存可能

環境省テレメータ取り合い共通仕様に適合した
デジタルテレメータ入出力機能を標準装備

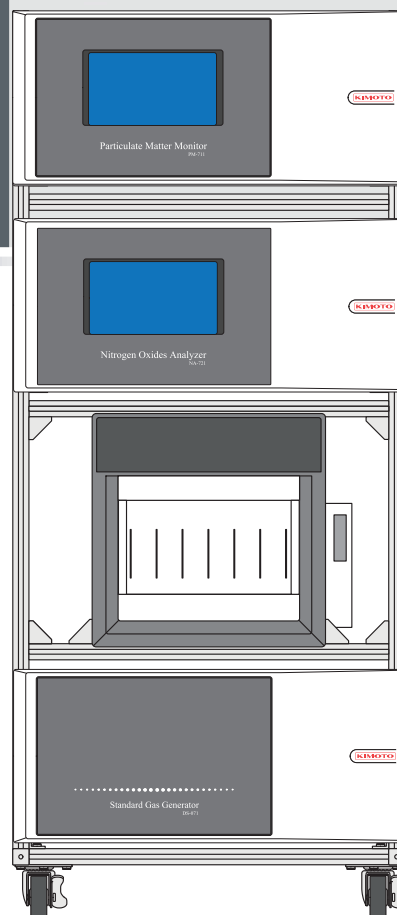

NAP-700

■ 分析部本体およびラックケース寸法

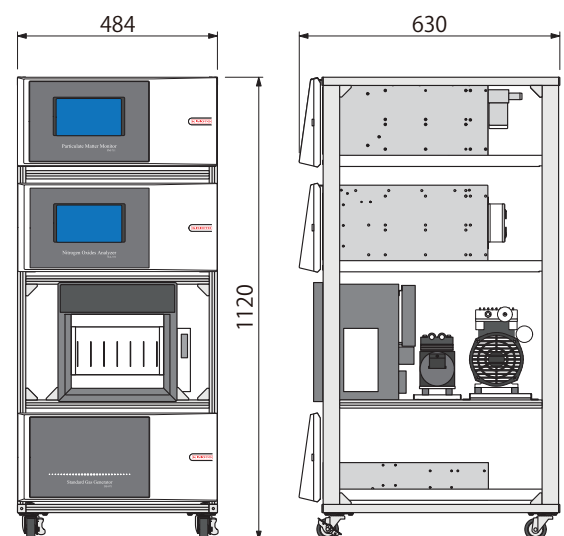

ラック組込型 (A1120) (DS-071N付:約76kg)

■ 基本構成

窒素酸化物自動計測器	NA-721
浮遊粒子状物質自動計測器	PM-711
床立型ラック	A1120:高さ1120mm キャスタ付フレームラック
レコーダ	打点式記録計 記録紙有効幅180mm
アナログテレメータ 入出力ユニット	TU07:ネジ締め端子台 (床立型ラック背面取付)

■ 周辺装置

標準ガス調製装置	DS-071N:流量比混合1点希釈装置 NA-721からの自動制御運転 コンバータ効率試験ガス発生機能内蔵 高純度ゼロガス発生器内蔵
----------	---

■ NA-721 仕様

測定対象	環境大気中の窒素酸化物 (NO ₂ , NO, NO _x)	干渉影響	4ppb以下 (NH ₃ 1ppm), 4%以下 (水分 25°C 80%RH)
測定原理	化学発光方式 (JIS B 7953)	暖機時間	3時間以下
測定範囲*	0~1ppm (標準), 0~2ppm (オプション)	許容周囲温度	0~40°C
アナログ出力レンジ*	0~0.1/ 0.2/ 0.5/ 1ppm 4レンジ自動切換 (標準), 0~0.2/ 0.5/ 1/ 2ppm 4レンジ自動 切換 (オプション) ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能	試料吸引流量	約1ℓ/分
繰返し性 (再現性)	スパンガス濃度の±1%	ダストフィルタ*	φ47mmふっ素樹脂フィルタ
ゼロドリフト	±1ppb/週	LCD表示	測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
スパンドリフト	スパンガス濃度の±2%/日, ±4%/週	内部メモリー保存	測定値 (1分値, 1時間値), 動作制御情報, メッセージ, アラーム
直線性 (指示誤差)	中間点スパンガス濃度の±4%	デジタル入出力	Ethernet, USB1.1, RS232C
電源電圧変動に対する 指示値の安定性	スパンガス濃度の±1%/100±10V	打点式記録計用出力*	連続値, 1時間積算平均値, 日報, 動作情報
周囲温度変化に対する 指示値の安定性	ゼロ: ±1ppb以内/5°C変化 スパン: スパンガス濃度の±2%以内/5°C変化	デジタルテレメータ用 入出力	環境省環境大気自動測定機のテレメータ 取り合いの共通仕様に適合した入出力
コンバータ効率	96%以上	アナログテレメータ用 入出力*	DC0~1V: 連続値, 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等
応答時間	3分以下 (最終指示値の90%までの時間)	電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 約300VA
検出限界	1ppb以下	耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし
		絶縁抵抗	5MΩ以上

(*) 標準外仕様についてはご相談ください。

■ PM-711 仕様

測定対象	環境大気中の浮遊粒子状物質	試料大気流量の 経時安定性	設定試料大気採取流量の±5%/10日
測定原理	β線吸収方式 (JIS B 7954)	捕集ろ紙	ふっ素樹脂製テープろ紙
測定範囲*	0~5mg/m ³	β線源*	¹⁴ C 放射線障害防止法規定下限数量 (10MBq) 未満 (取扱資格及び届出不要)
アナログ出力レンジ*	0~0.5/ 1/ 2/ 5mg/m ³ 4レンジ自動切換 ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能	検出器	プラスチックシンチレーション検出器
繰返し性 (再現性)	等価膜値の±2%	分級装置*	SPMサイクロン (標準), PM _{2.5} サイクロン (オプション), PM ₁₀ インパクタ (オプション)
ゼロドリフト	±5.0μg/m ³ /日	LCD表示	測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
スパンドリフト	等価膜値の±3%/日	内部メモリー保存	測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
直線性 (指示誤差)	等価膜値の±5%	デジタル入出力	Ethernet, USB1.1, RS232C
校正用空気に対する 指示値	質量濃度の±10%	打点式記録計用出力*	1時間積算平均値, 日報, 動作情報
粒子状物質を含まない 空気に対する指示値 (空試験)	±5.0μg/m ³ (平均値)	デジタルテレメータ用 入出力	環境省環境大気自動測定機のテレメータ 取り合いの共通仕様に適合した入出力
電源電圧変動に対する 指示値の安定性	等価膜値の±3%/100±10V	アナログテレメータ用 入出力*	DC0~1V: 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等
電源電圧変動に対する 試料大気流量の安定性	設定試料大気採取流量の±5%/100±10V	電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 約400VA
試料大気採取流量	16.7ℓ/分 (20°C, 1atm)	耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし
		絶縁抵抗	5MΩ以上

(*) 標準外仕様についてはご相談ください。



安全に関するご注意

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。

人・社会・自然の関わりをはかる

KIMOTO

紀本電子工業株式会社

<http://www.kimoto-electric.co.jp/>

■ 本社・工場

〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町3-1
TEL 06-6768-3401 FAX 06-6764-7040

■ 東京営業所

〒140-0013 東京都品川区南大井3-24-13
TEL 03-3761-8191 FAX 03-3761-8194

✉ E-Mail

sales@kimoto-electric.co.jp